


携帯電話端末等が植込み型心臓ペースメーカに及ぼす影響について

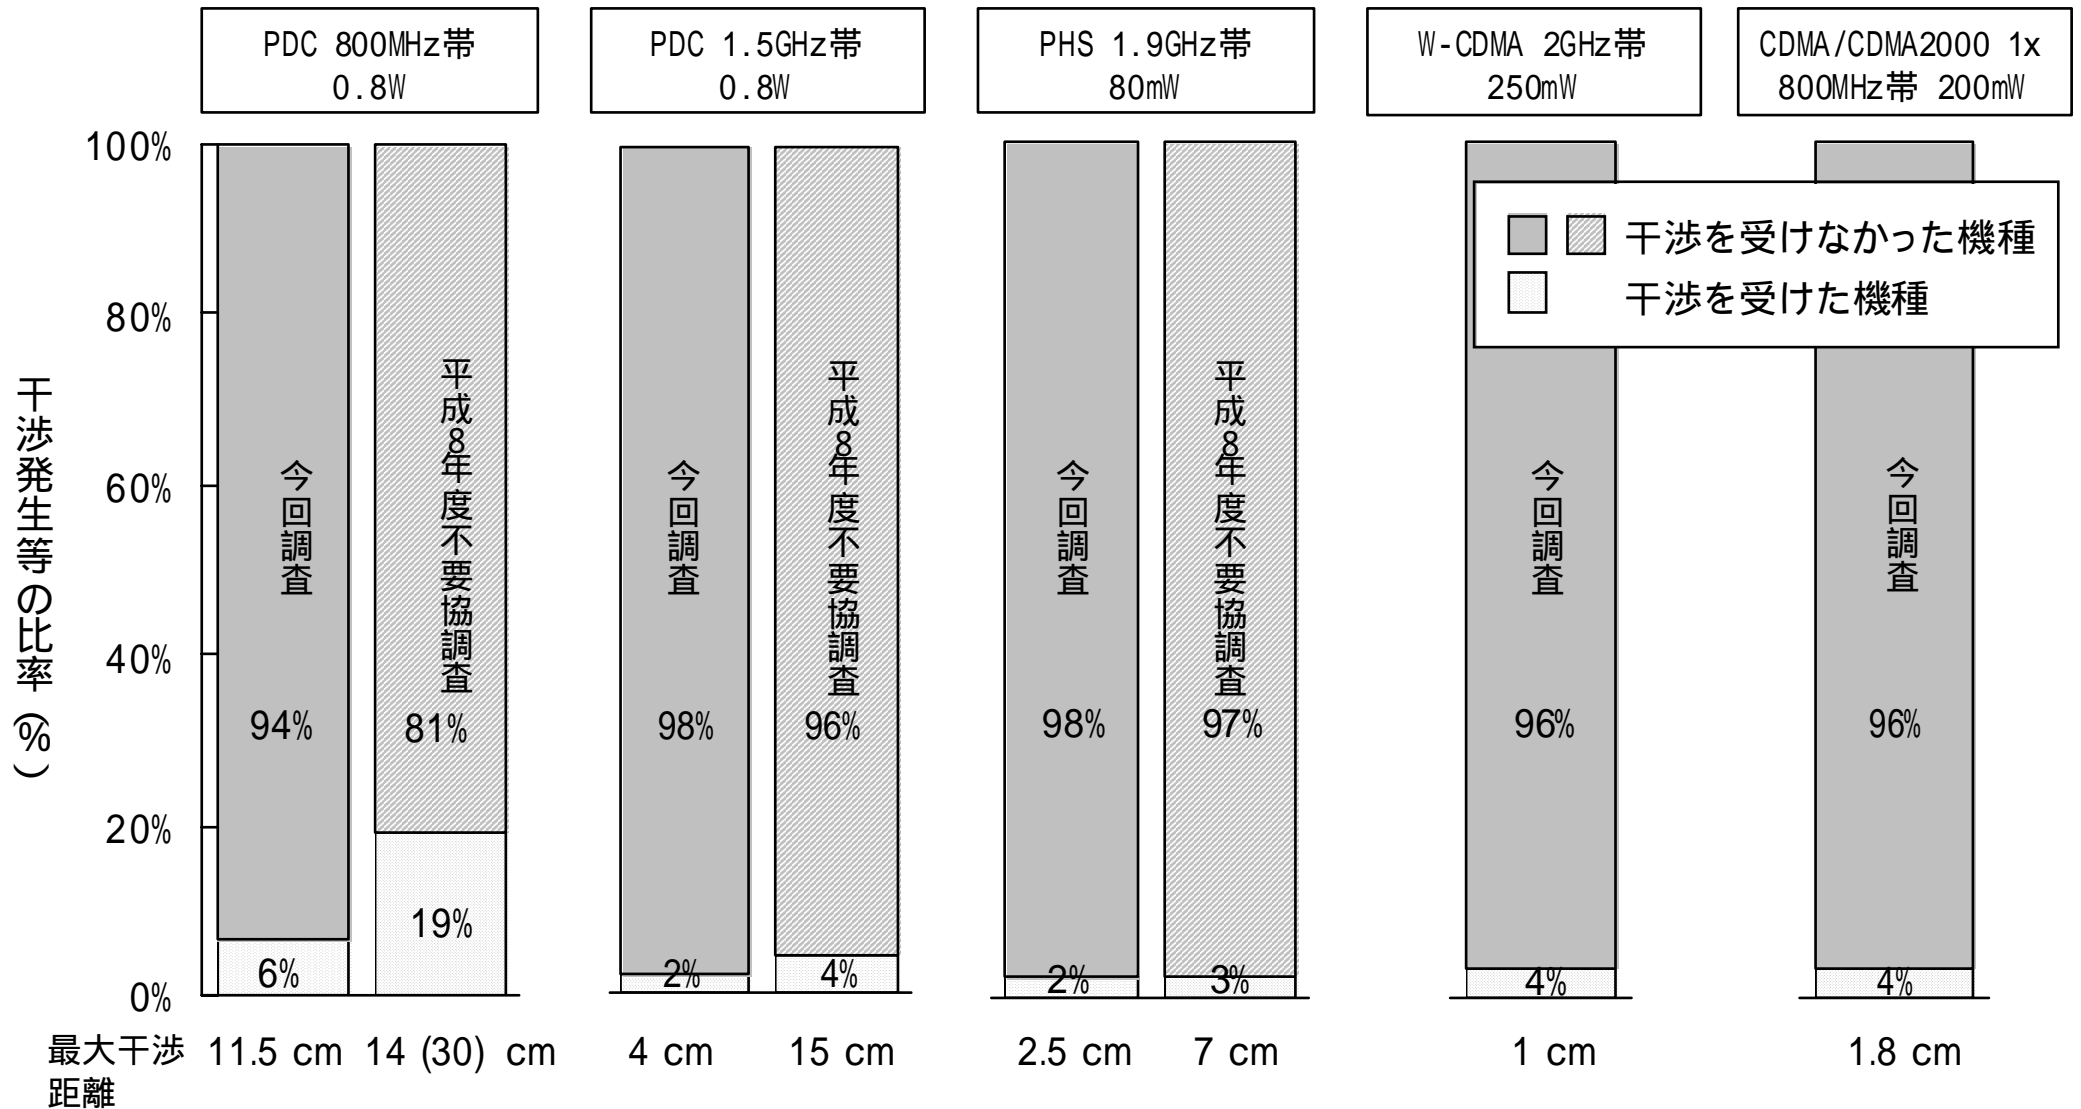

30cmの距離で影響が出た1機種については、全関連医療機関及び患者に対して安全情報提供の周知徹底を実施済み。

最大干渉距離：携帯電話端末等と調査対象医用機器との距離において、携帯電話端末等から発射された電波が調査対象医用機器に影響を及ぼしたときの最大距離をいう。